


# EXTRASYSTOLES

René Bastian

pour VCS 3 et réinjection

(1972)

## A. DISPOSITIF

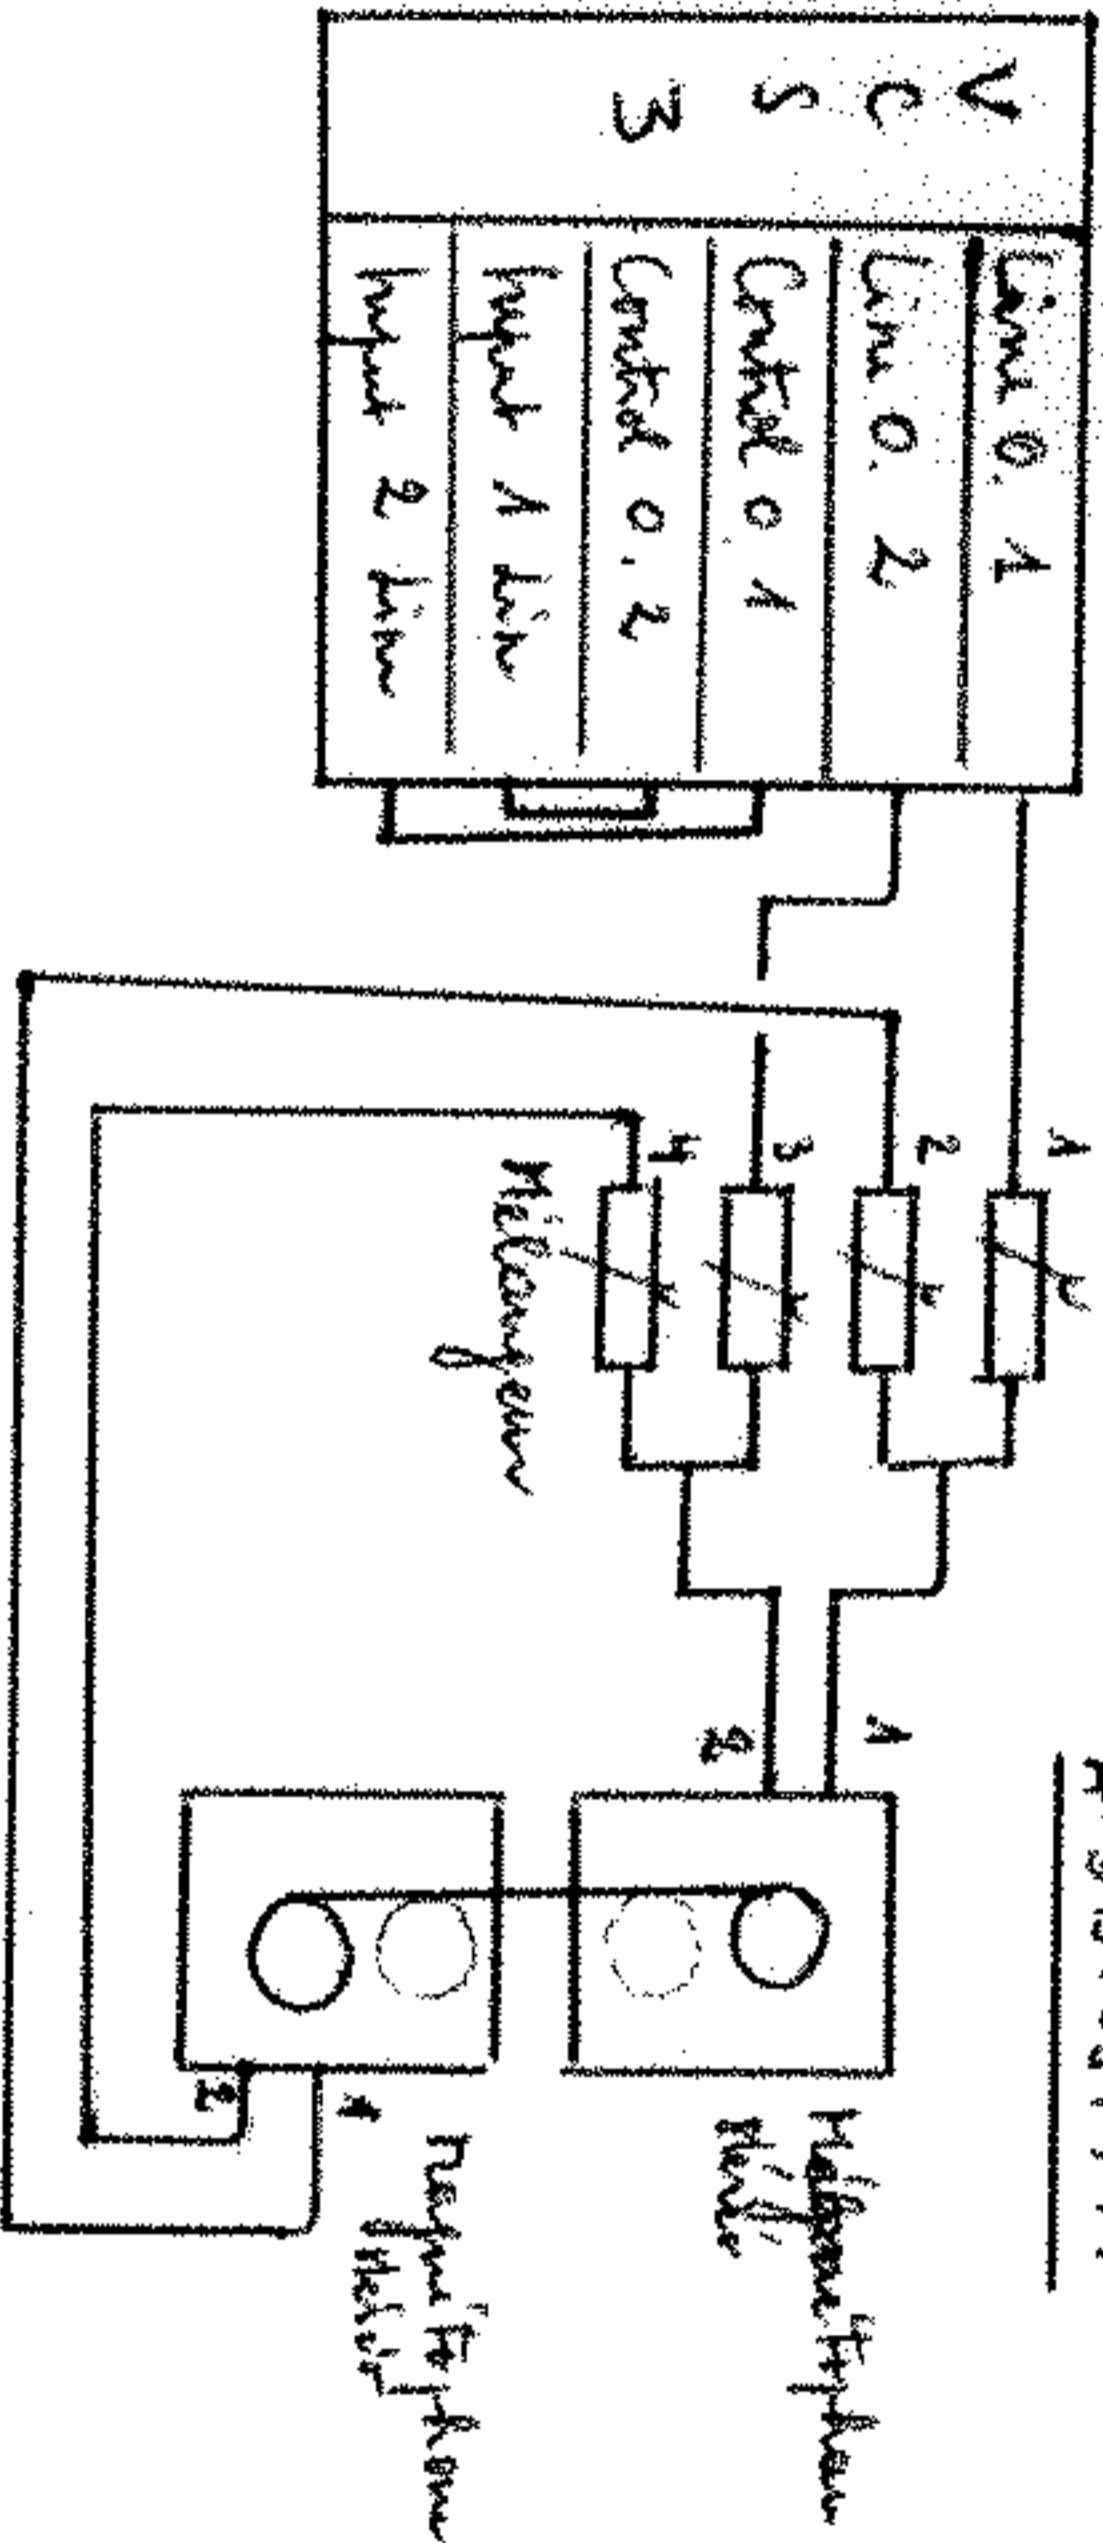

La bande utilisée pour la réinjection passe à un magnétophone à l'entre. L'écart de réinjection doit être de 6 à 8 sec.

## B. Programmation

7,8	5	0	0	0	0	0	0	10
0,3	5	2	0	0	0	3	5	
5,5	5	4	7	6	0	0	10	
5	10	0	0	5				
0	0	10	0					

Aucune fiche n'est programmée dans la matrice.

**A** ○○○○ ○○○○ fréquence/shape/level lehnus/level sois de l'osc. 1 (le pot. utilisé est forcé)

**N6** ○○○○ notor/level du noise generator

**RM** ○○○○ level du ring modulator

**F** ○○○○ ○○○○ fréquence/résonance/level du filtre

**E** ○○○○ ○○○○ ○○○○ attack/décay/offtime/level de l'env. shaper

**T** ○○○○ trapezoid





**R** ○○○○ mix/level du réverbérateur








**OP** ○○○○ output filtres 1 et 2

**I1** ○○○○ **I2** ○○○○ input 1/2 ou input 1




**▷** ○○○○ ○○○○ amplis de sortie **M**/gauche/droite/ampl 2



1

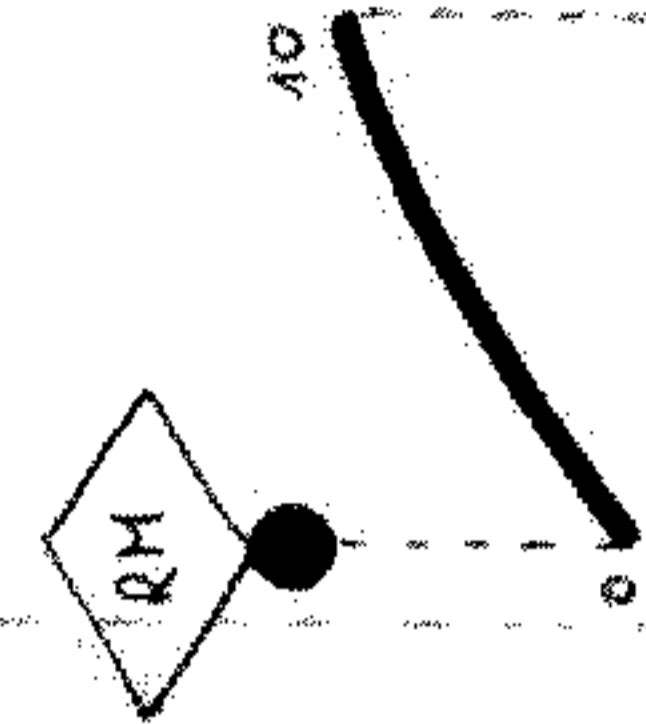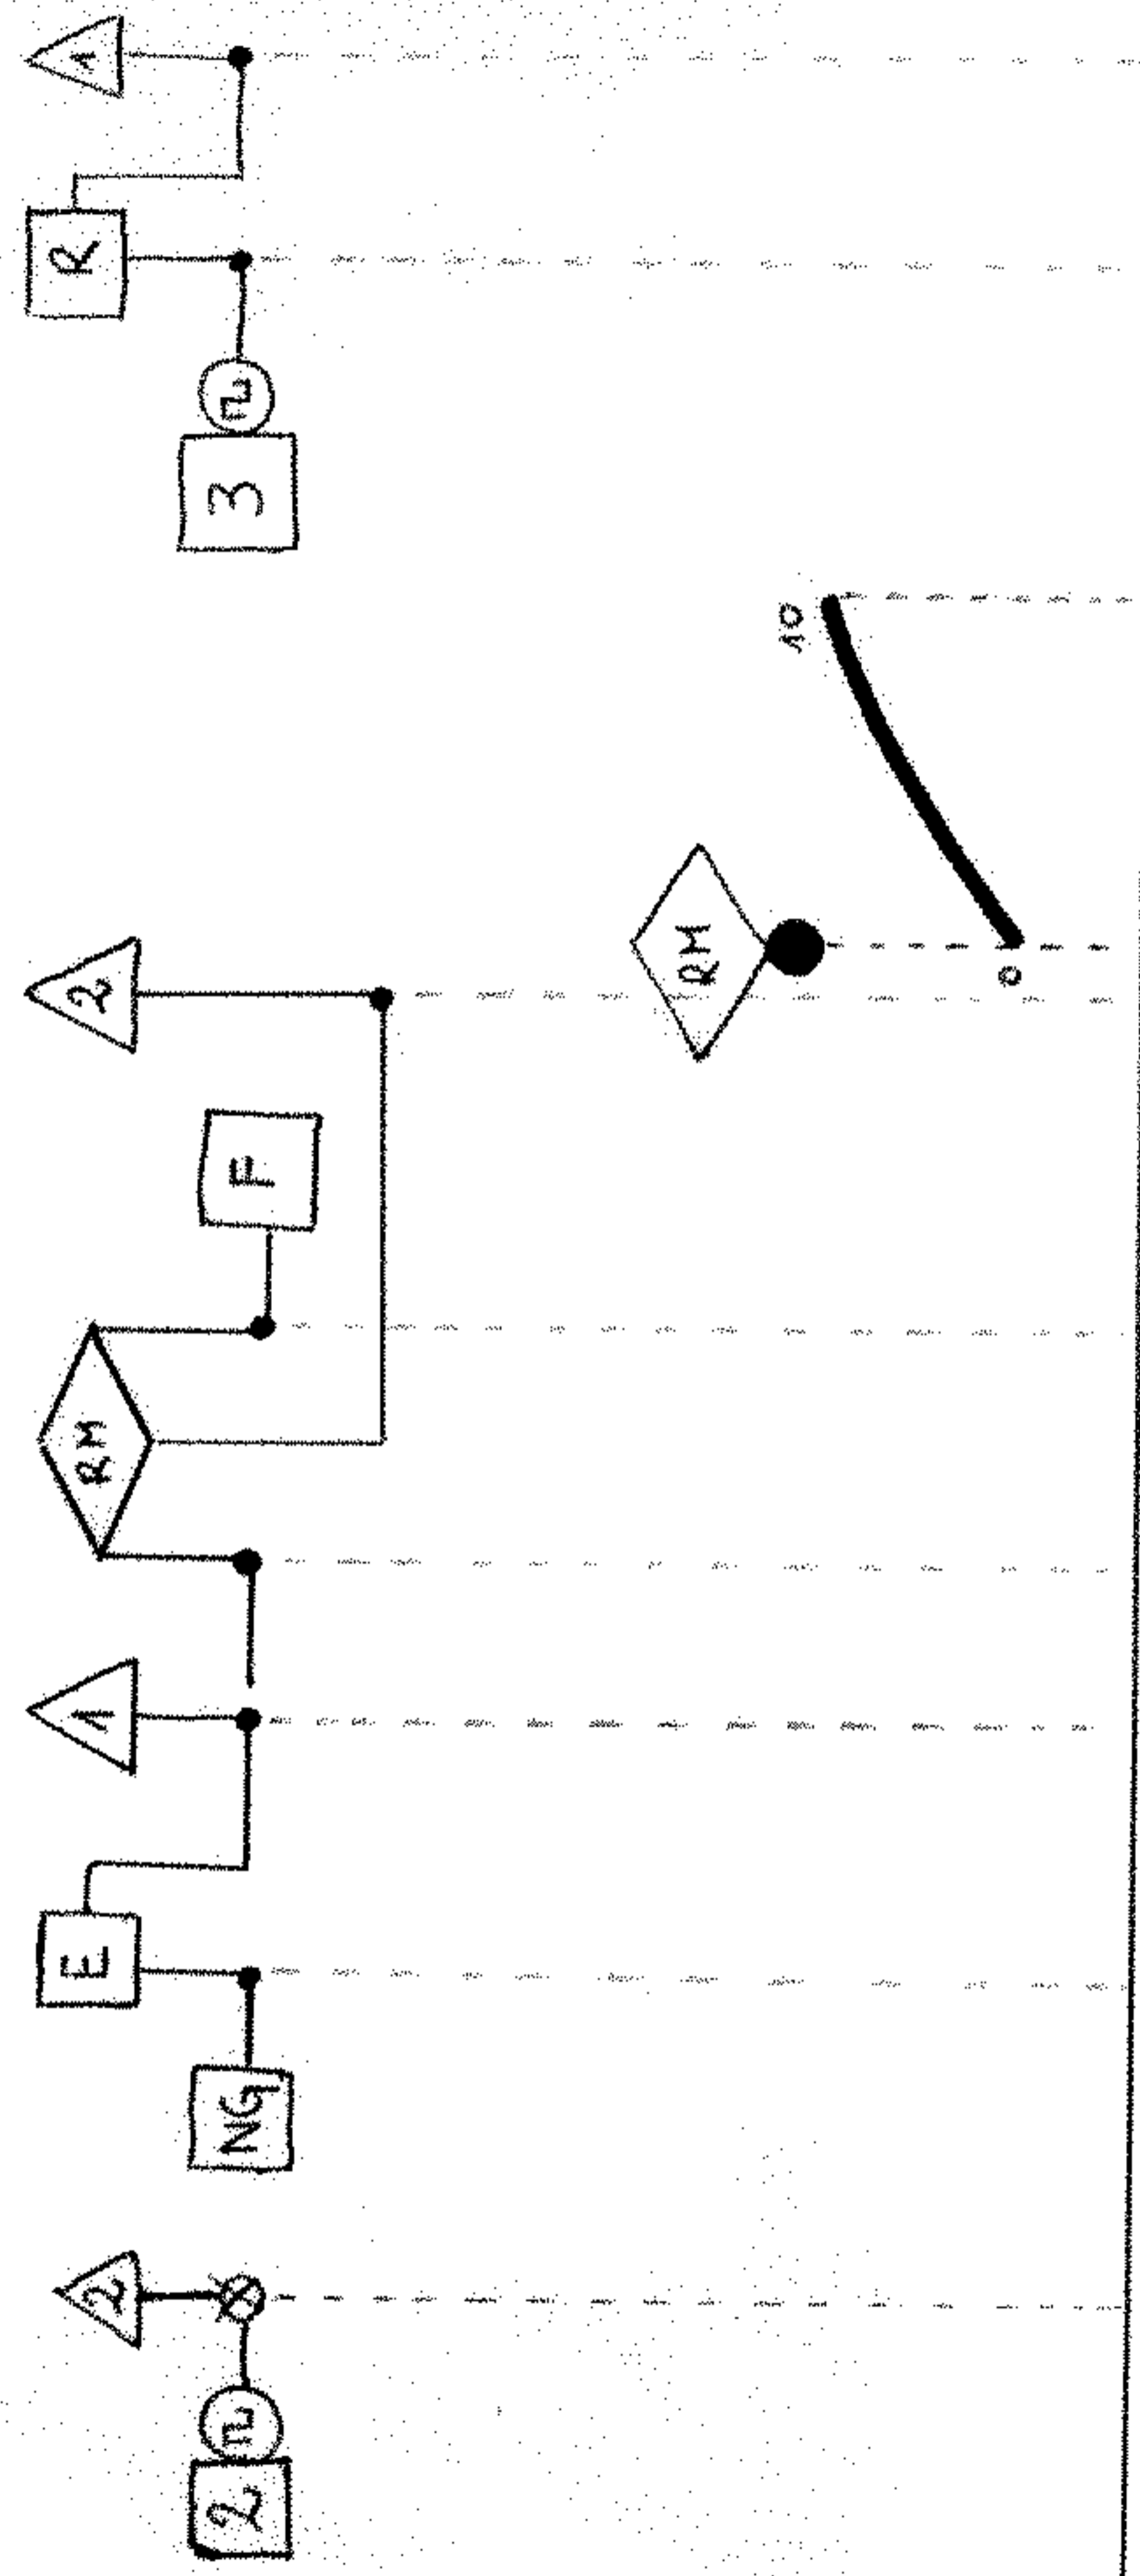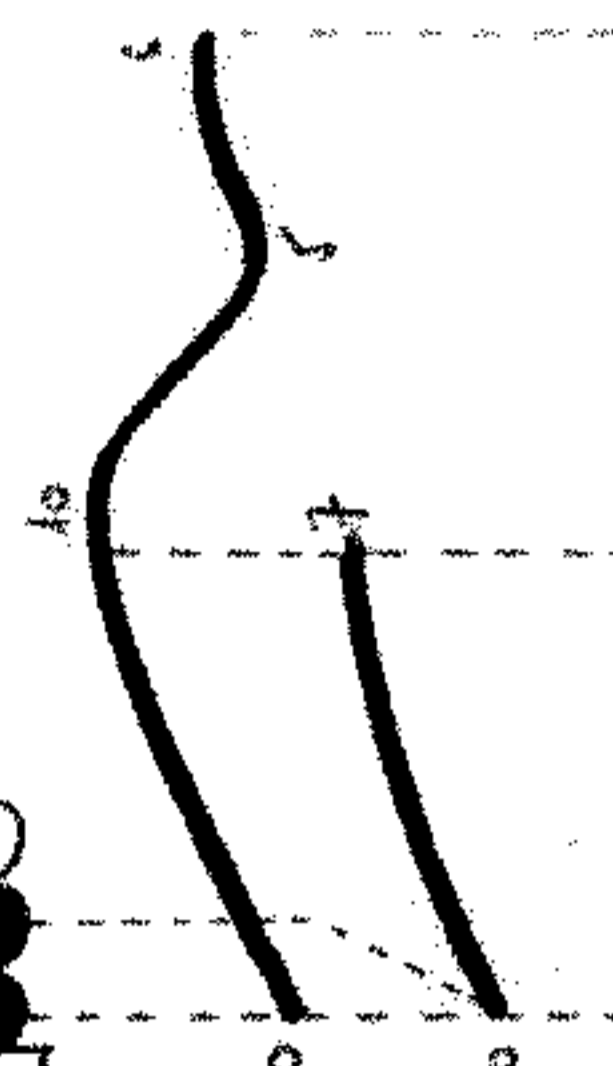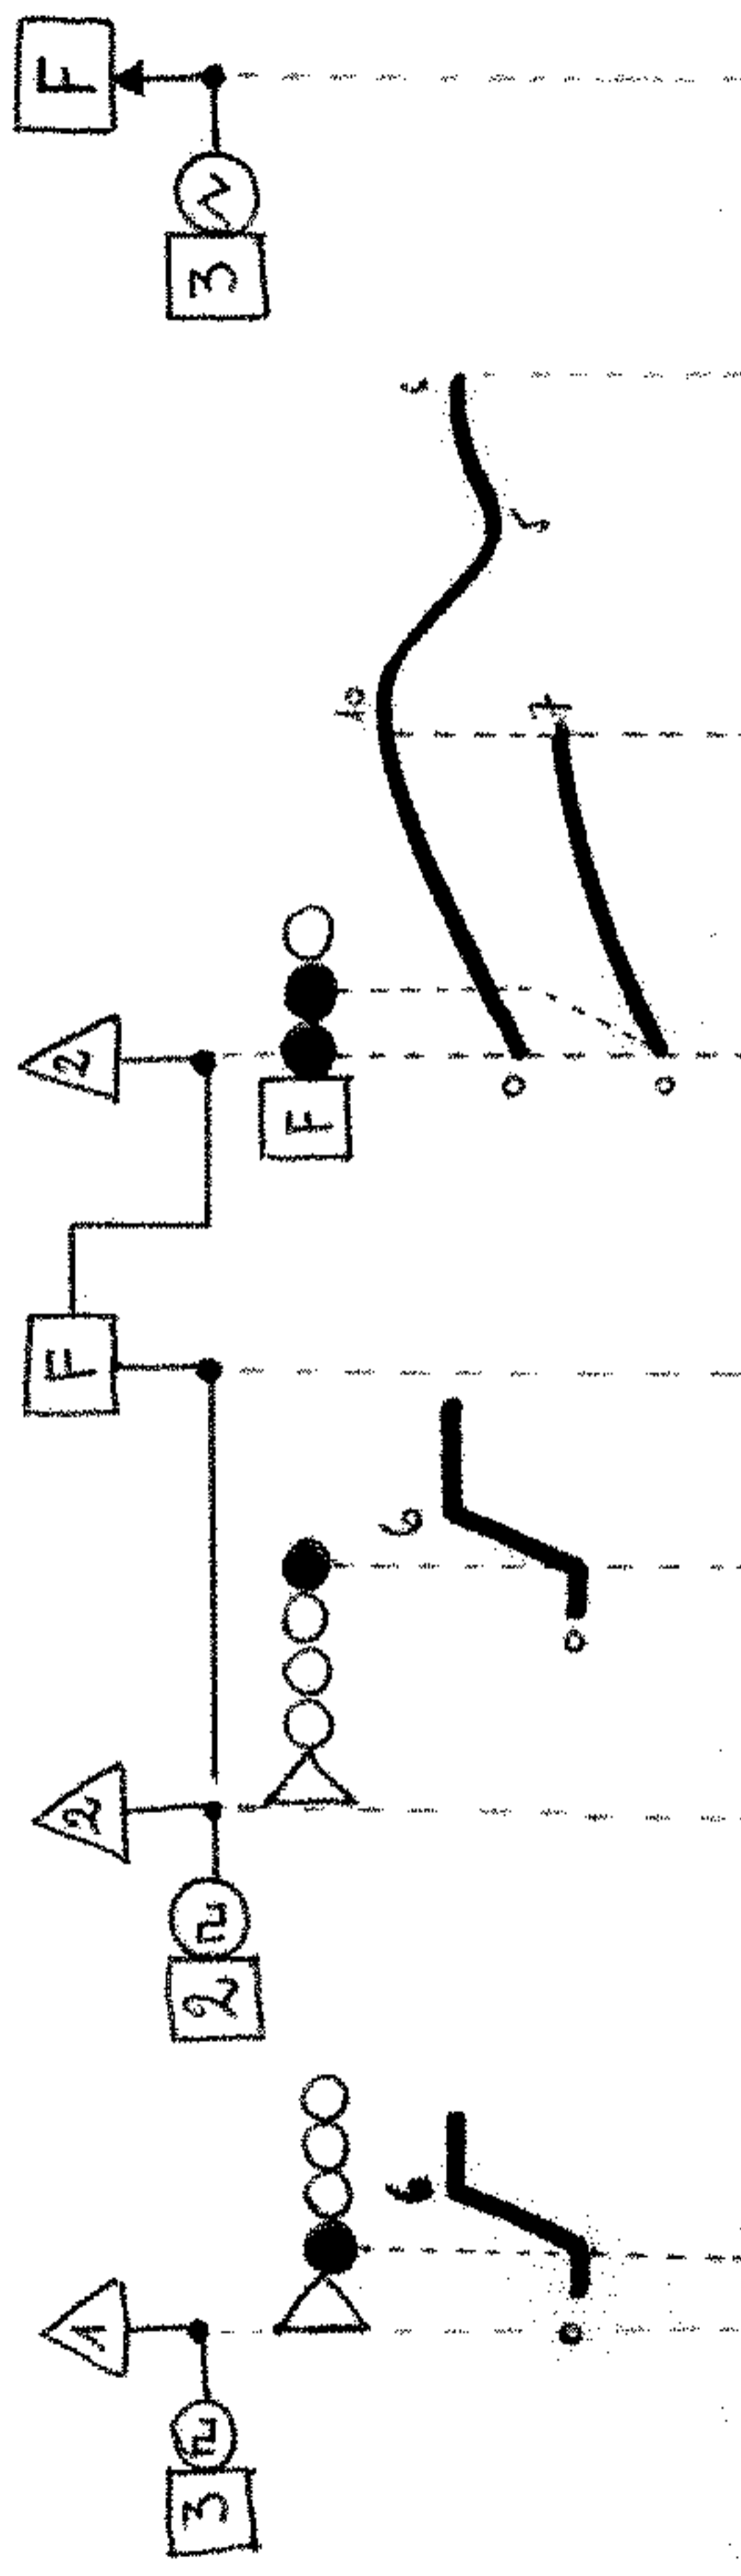


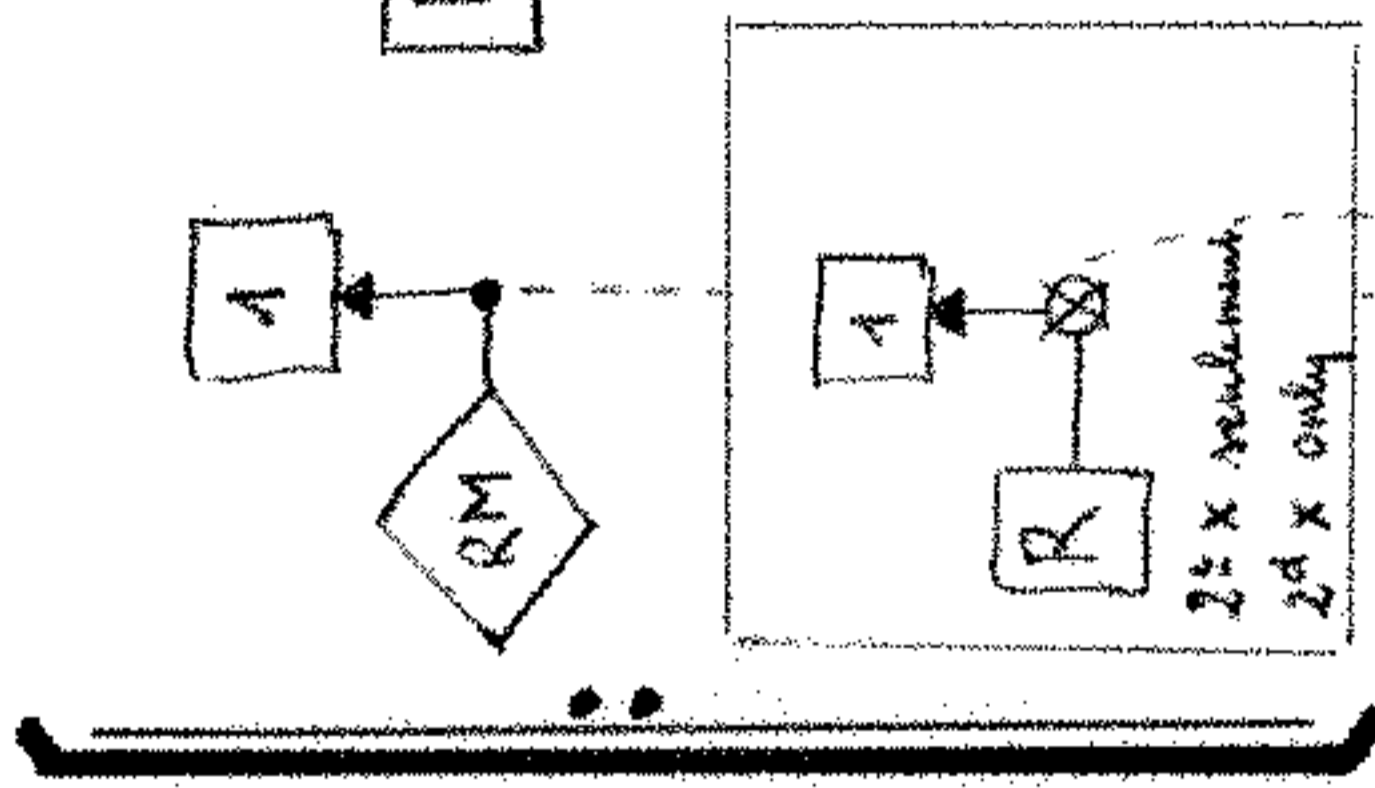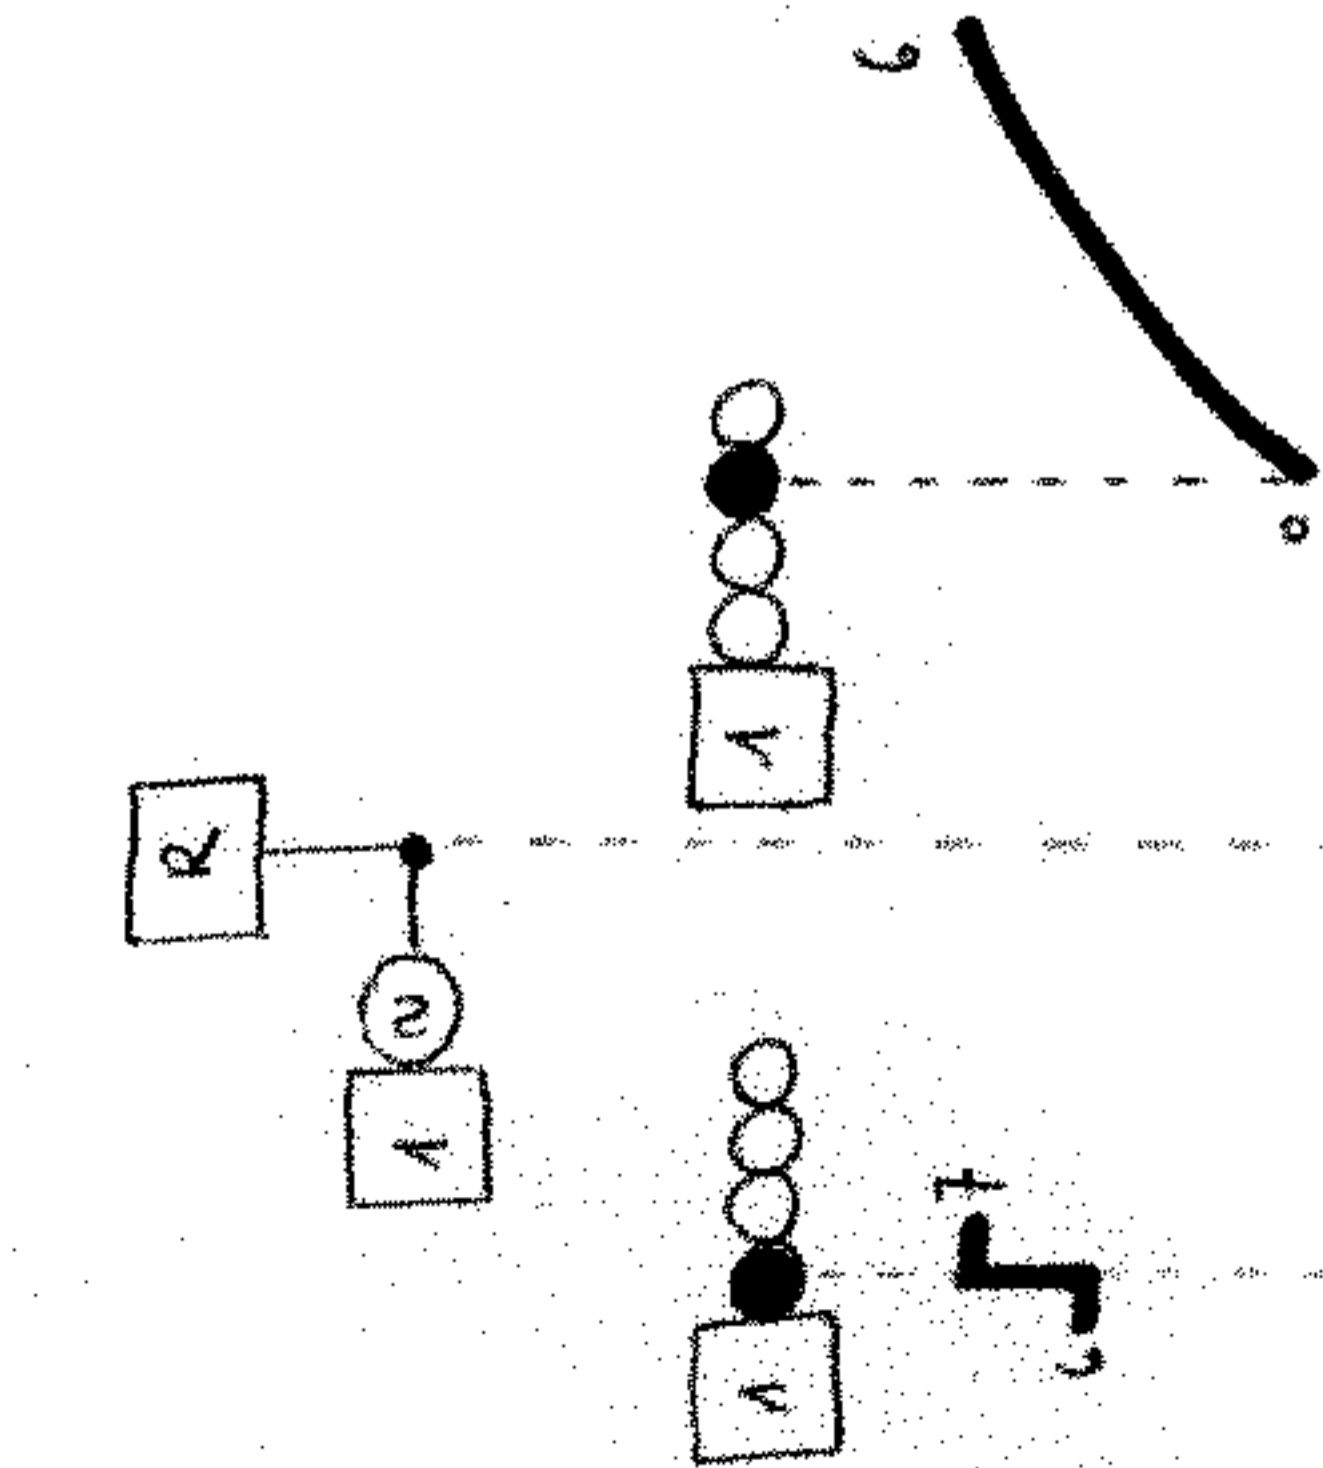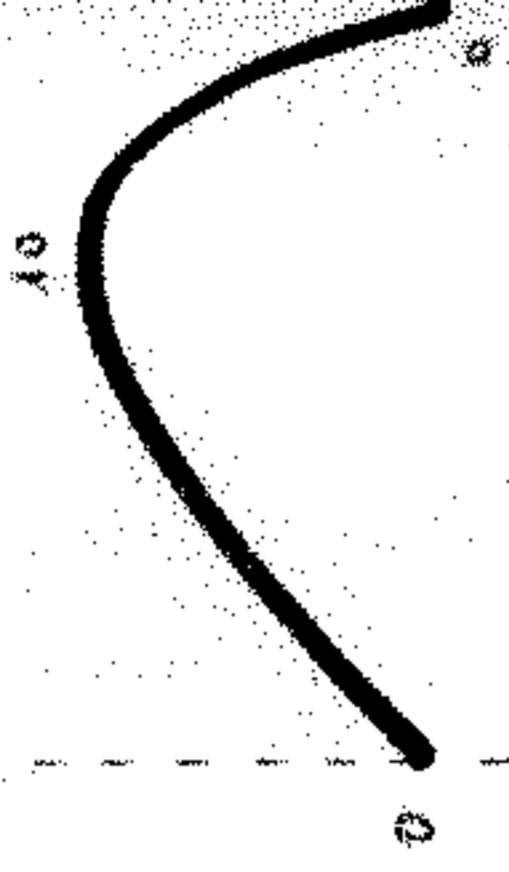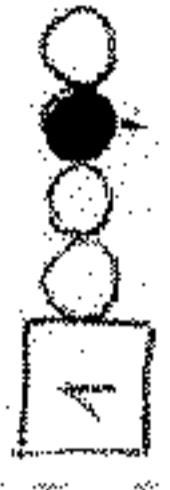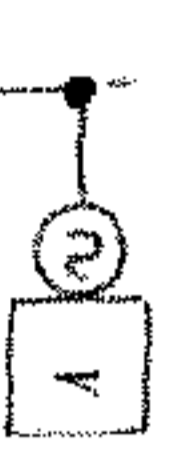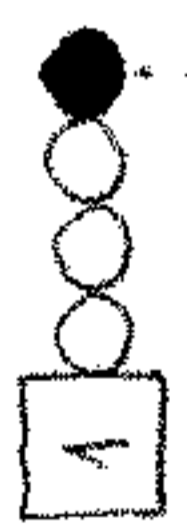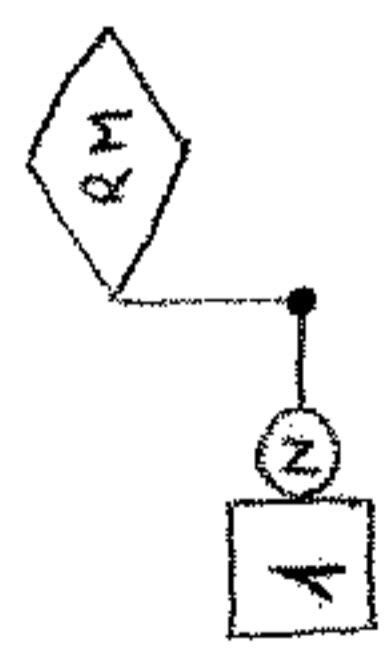

2<sup>nd</sup> x replacement  
2<sup>nd</sup> x only

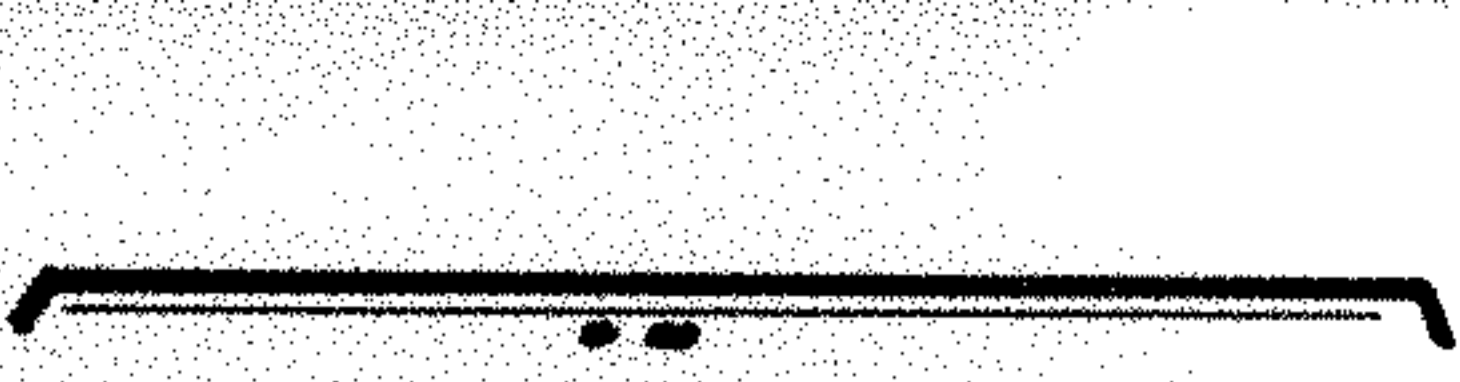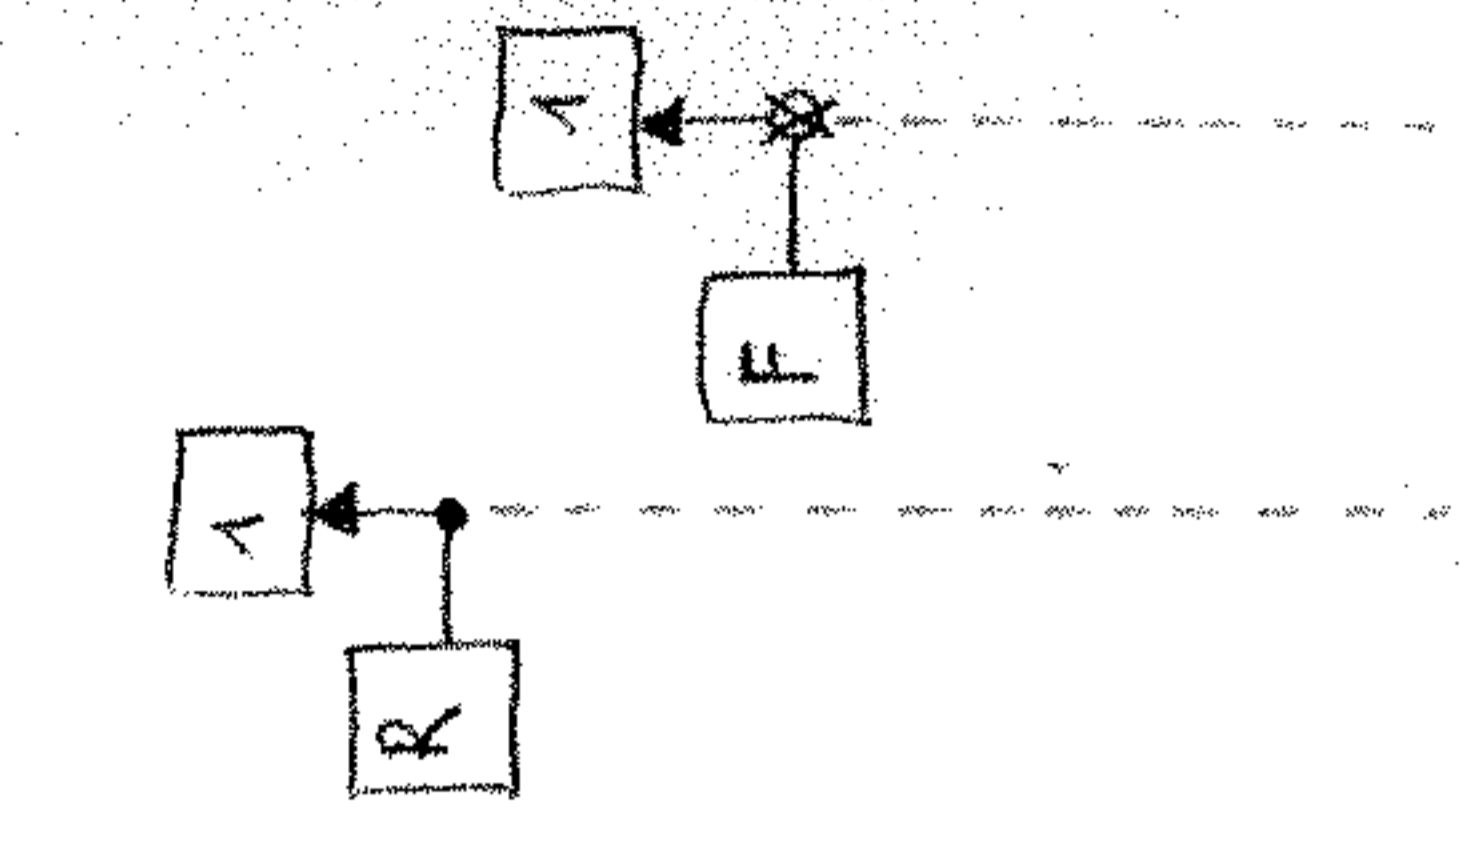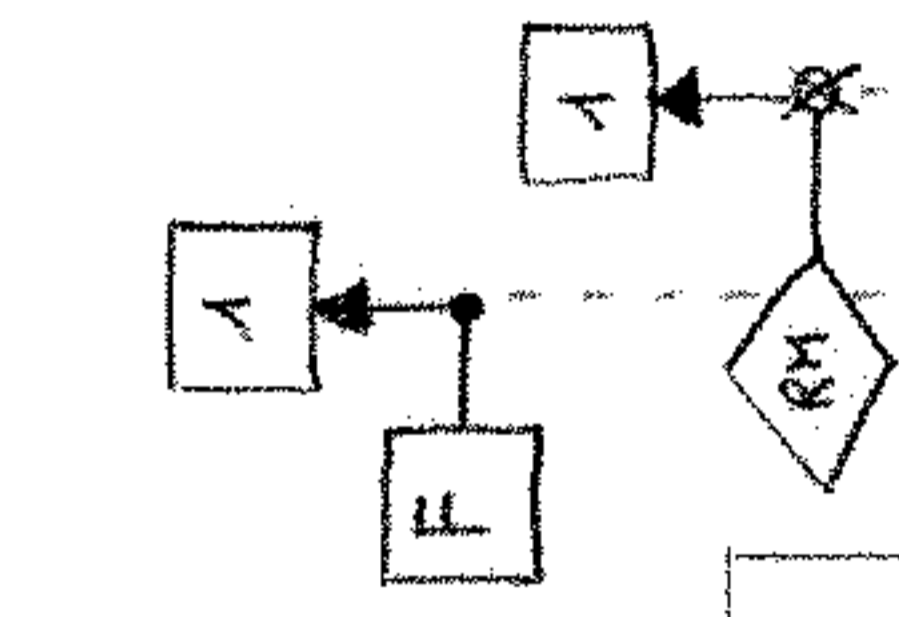

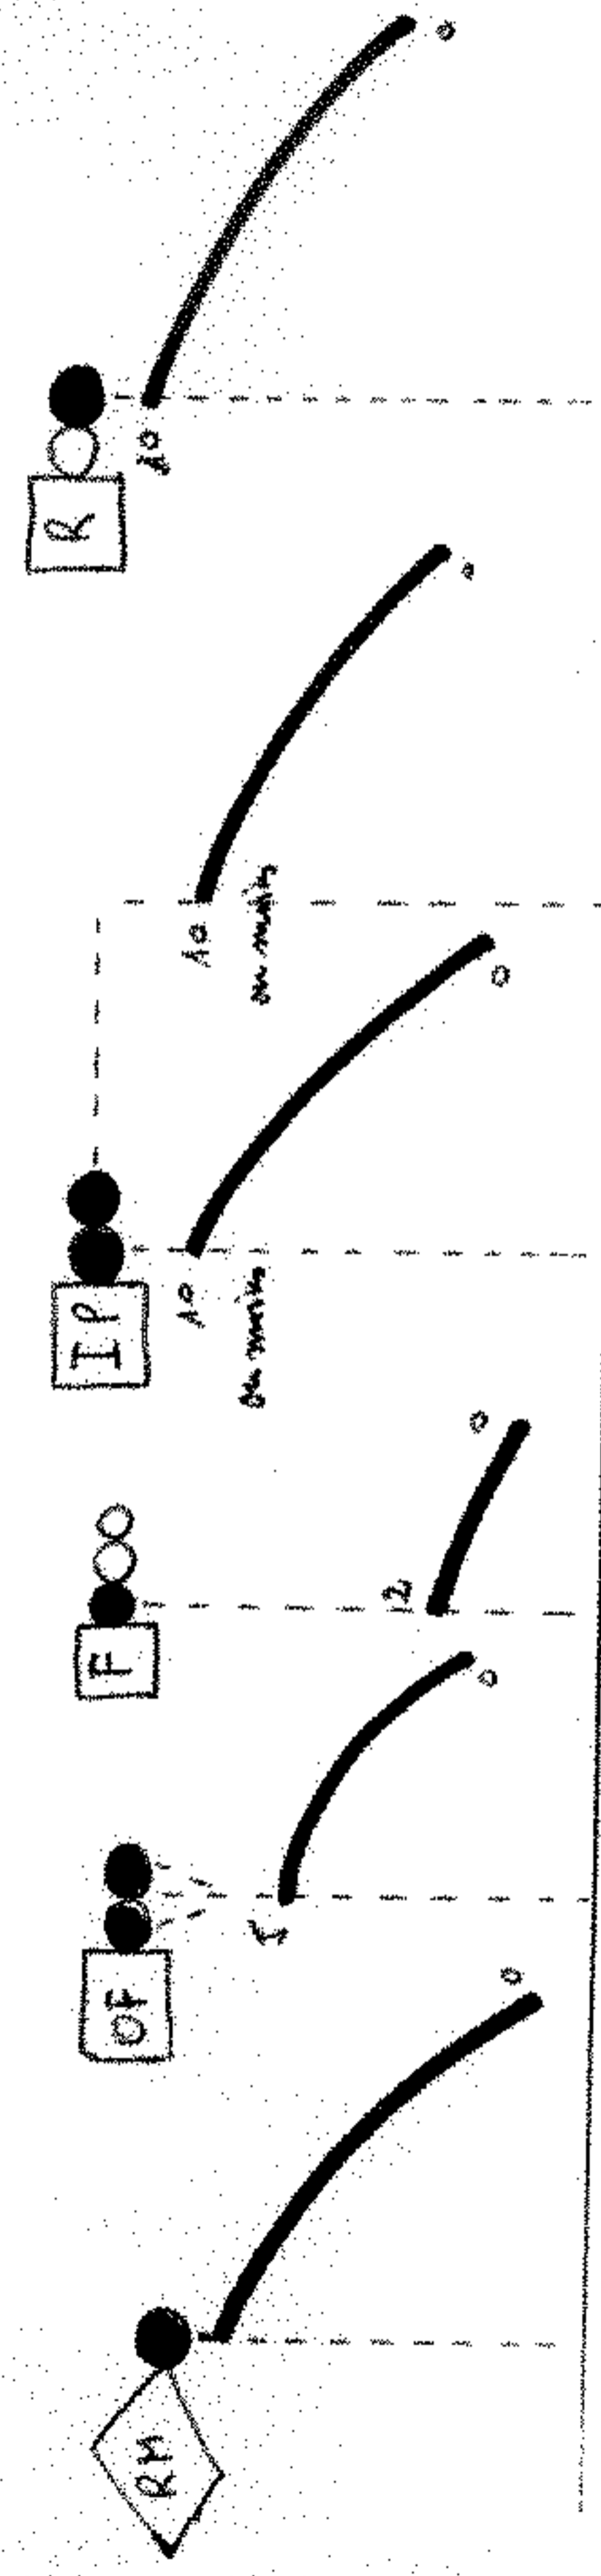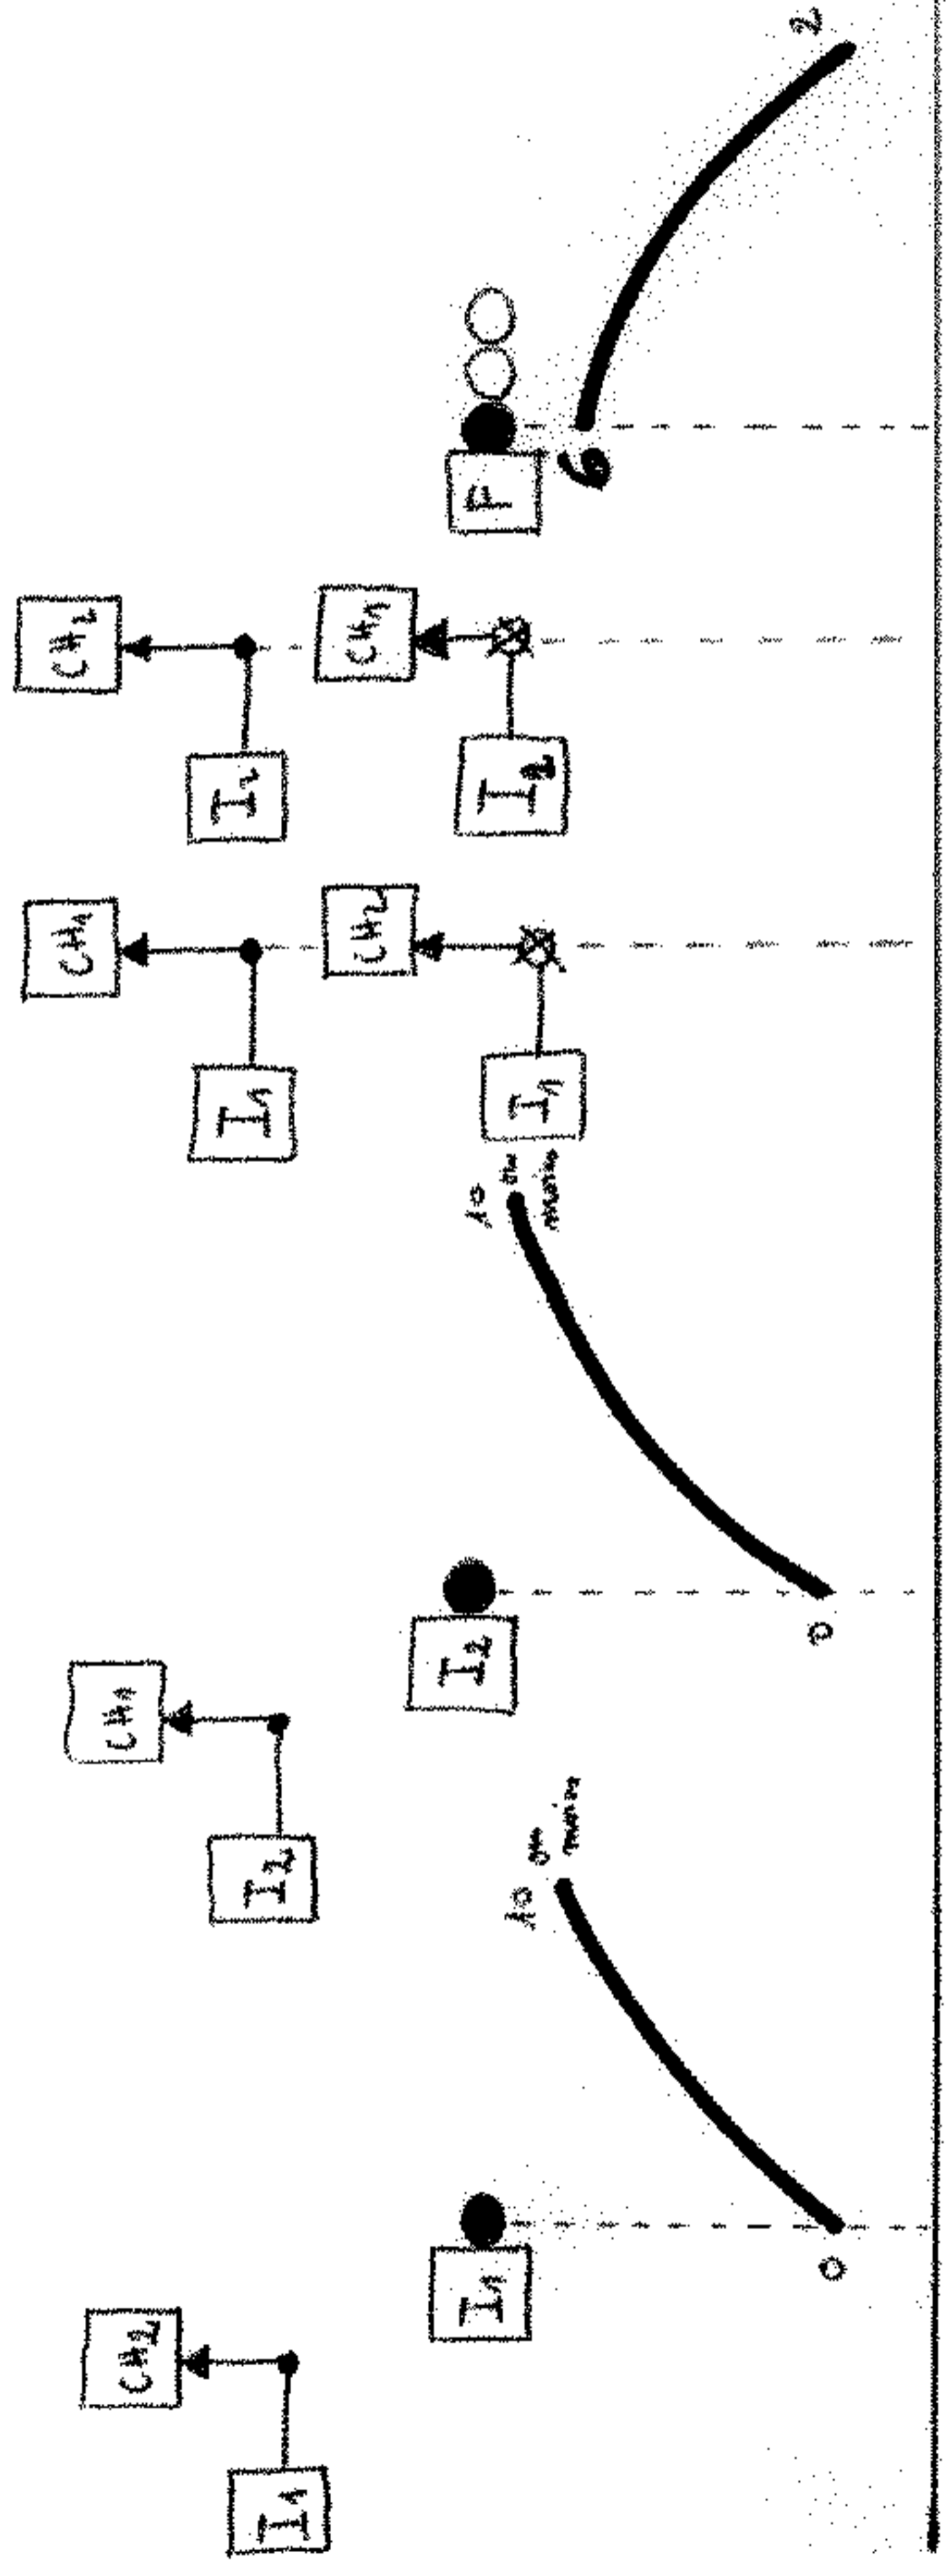

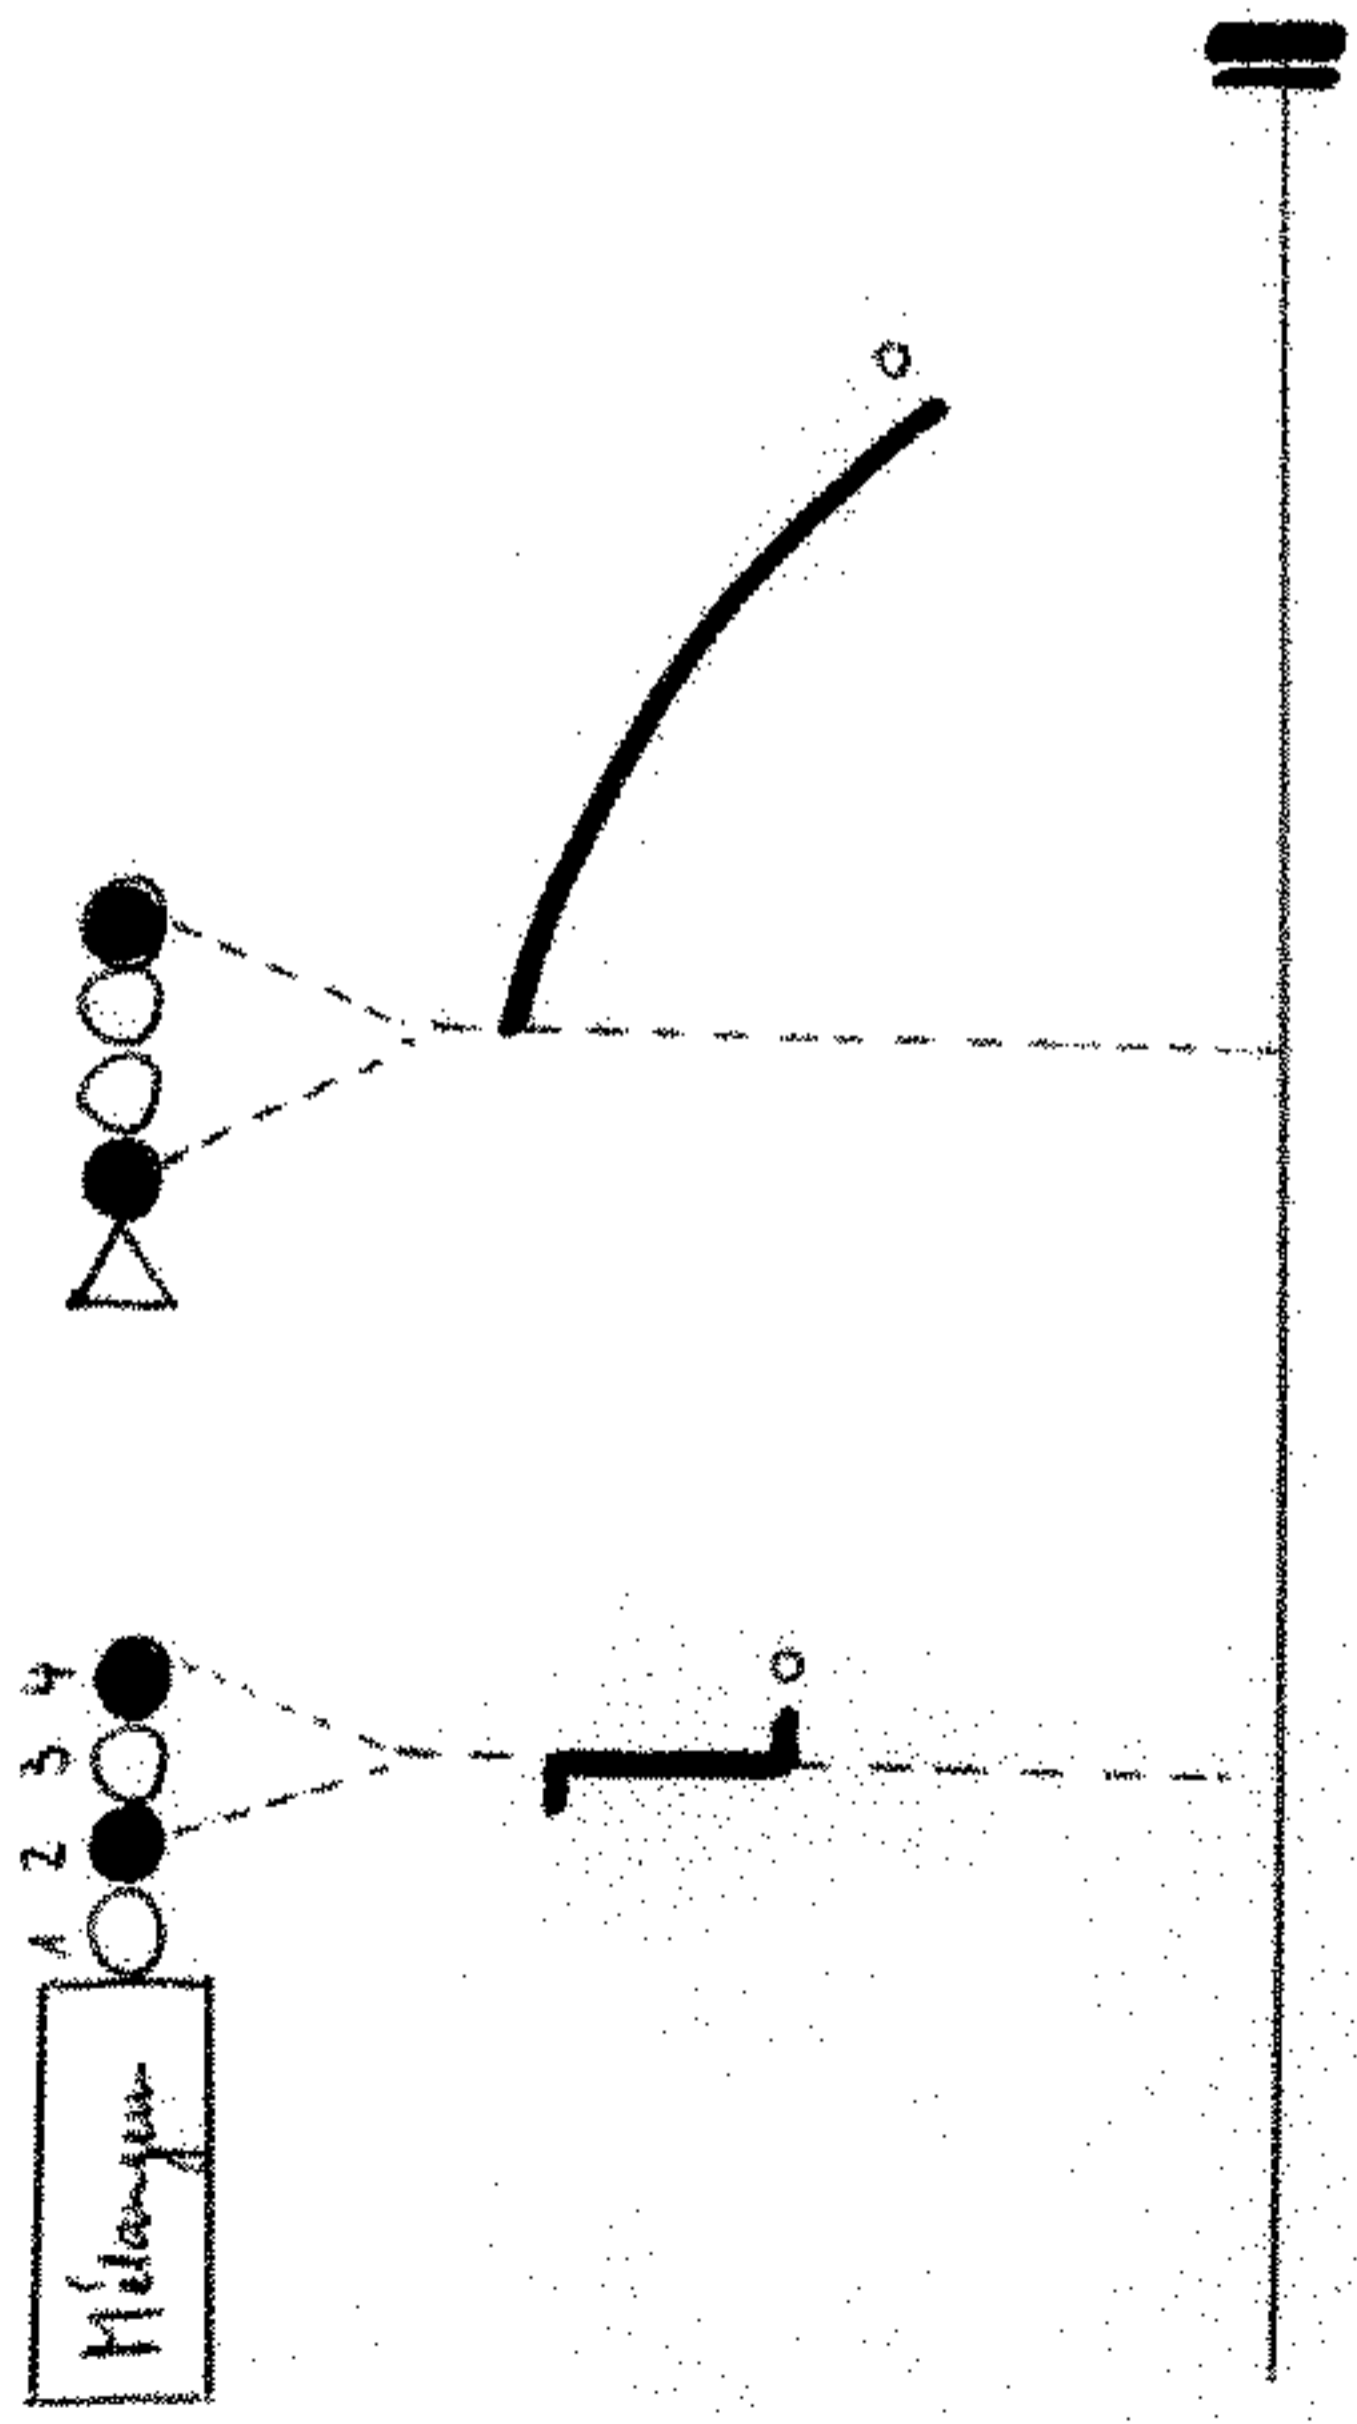

NB les canaux 2 et 4 sont les canaux de réinjection